



東京VORDME特別検査 資料①

オービットフライト: 空港に設置された無線施設からの円弧飛行
レベルラン: 高度を一定に維持し水平飛行

※: 検査終了後、次の開始点へ移動

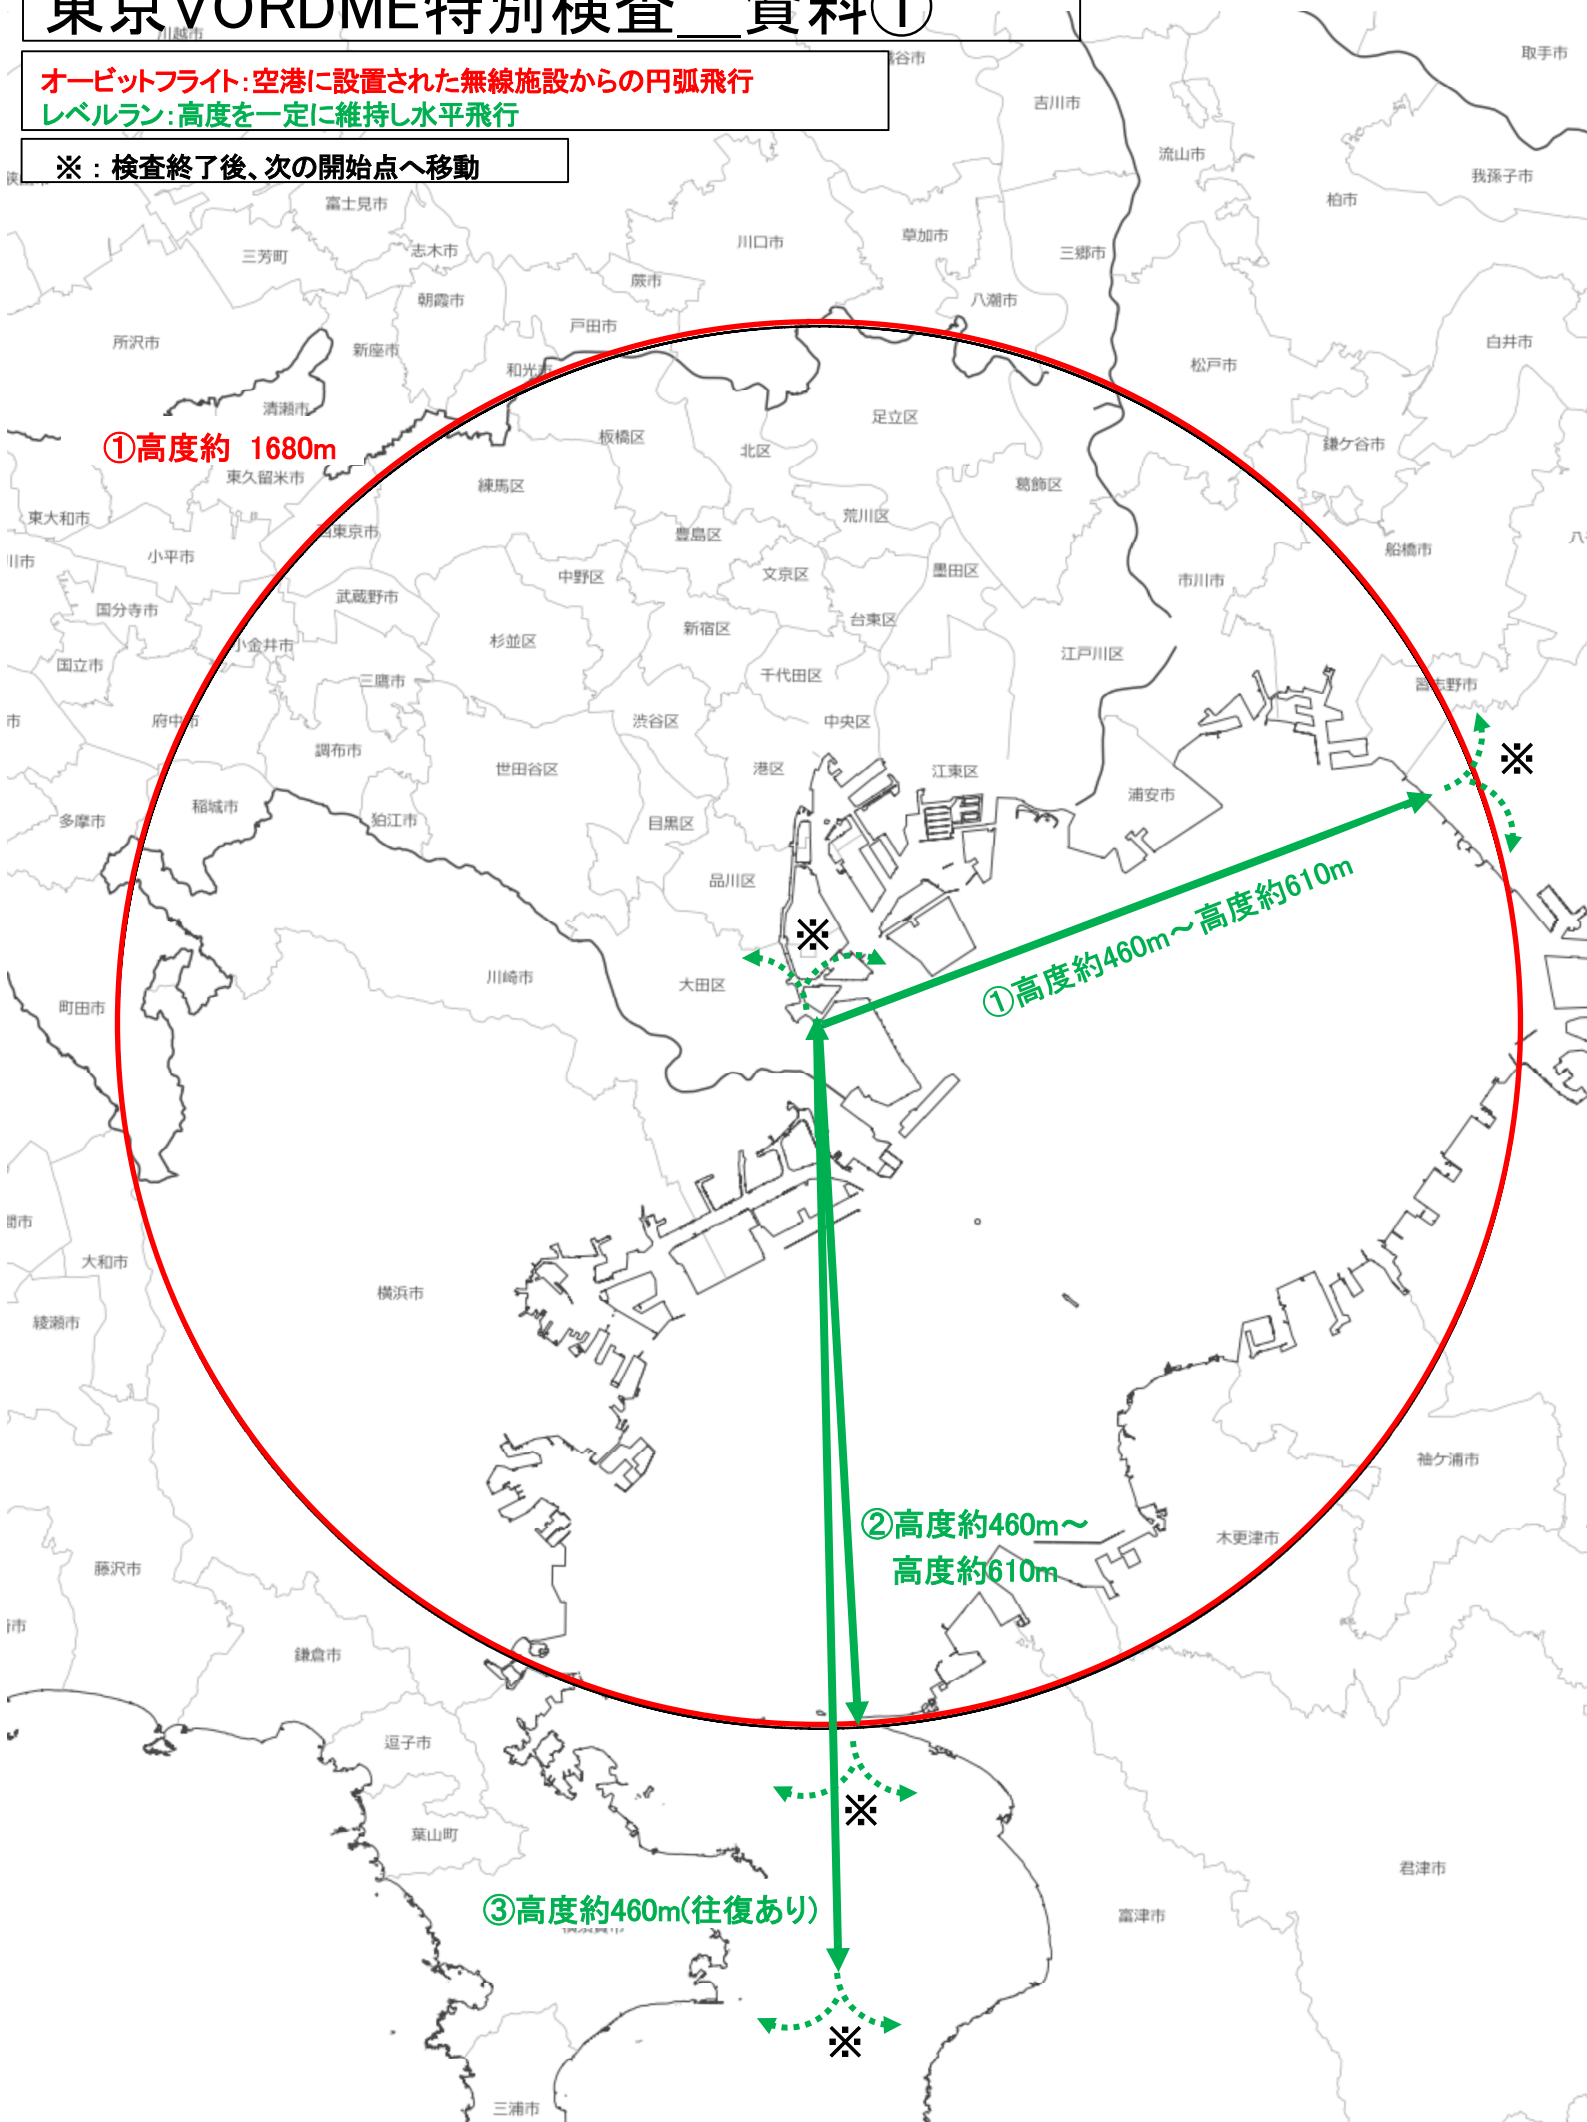

東京VORDME特別検査__資料②

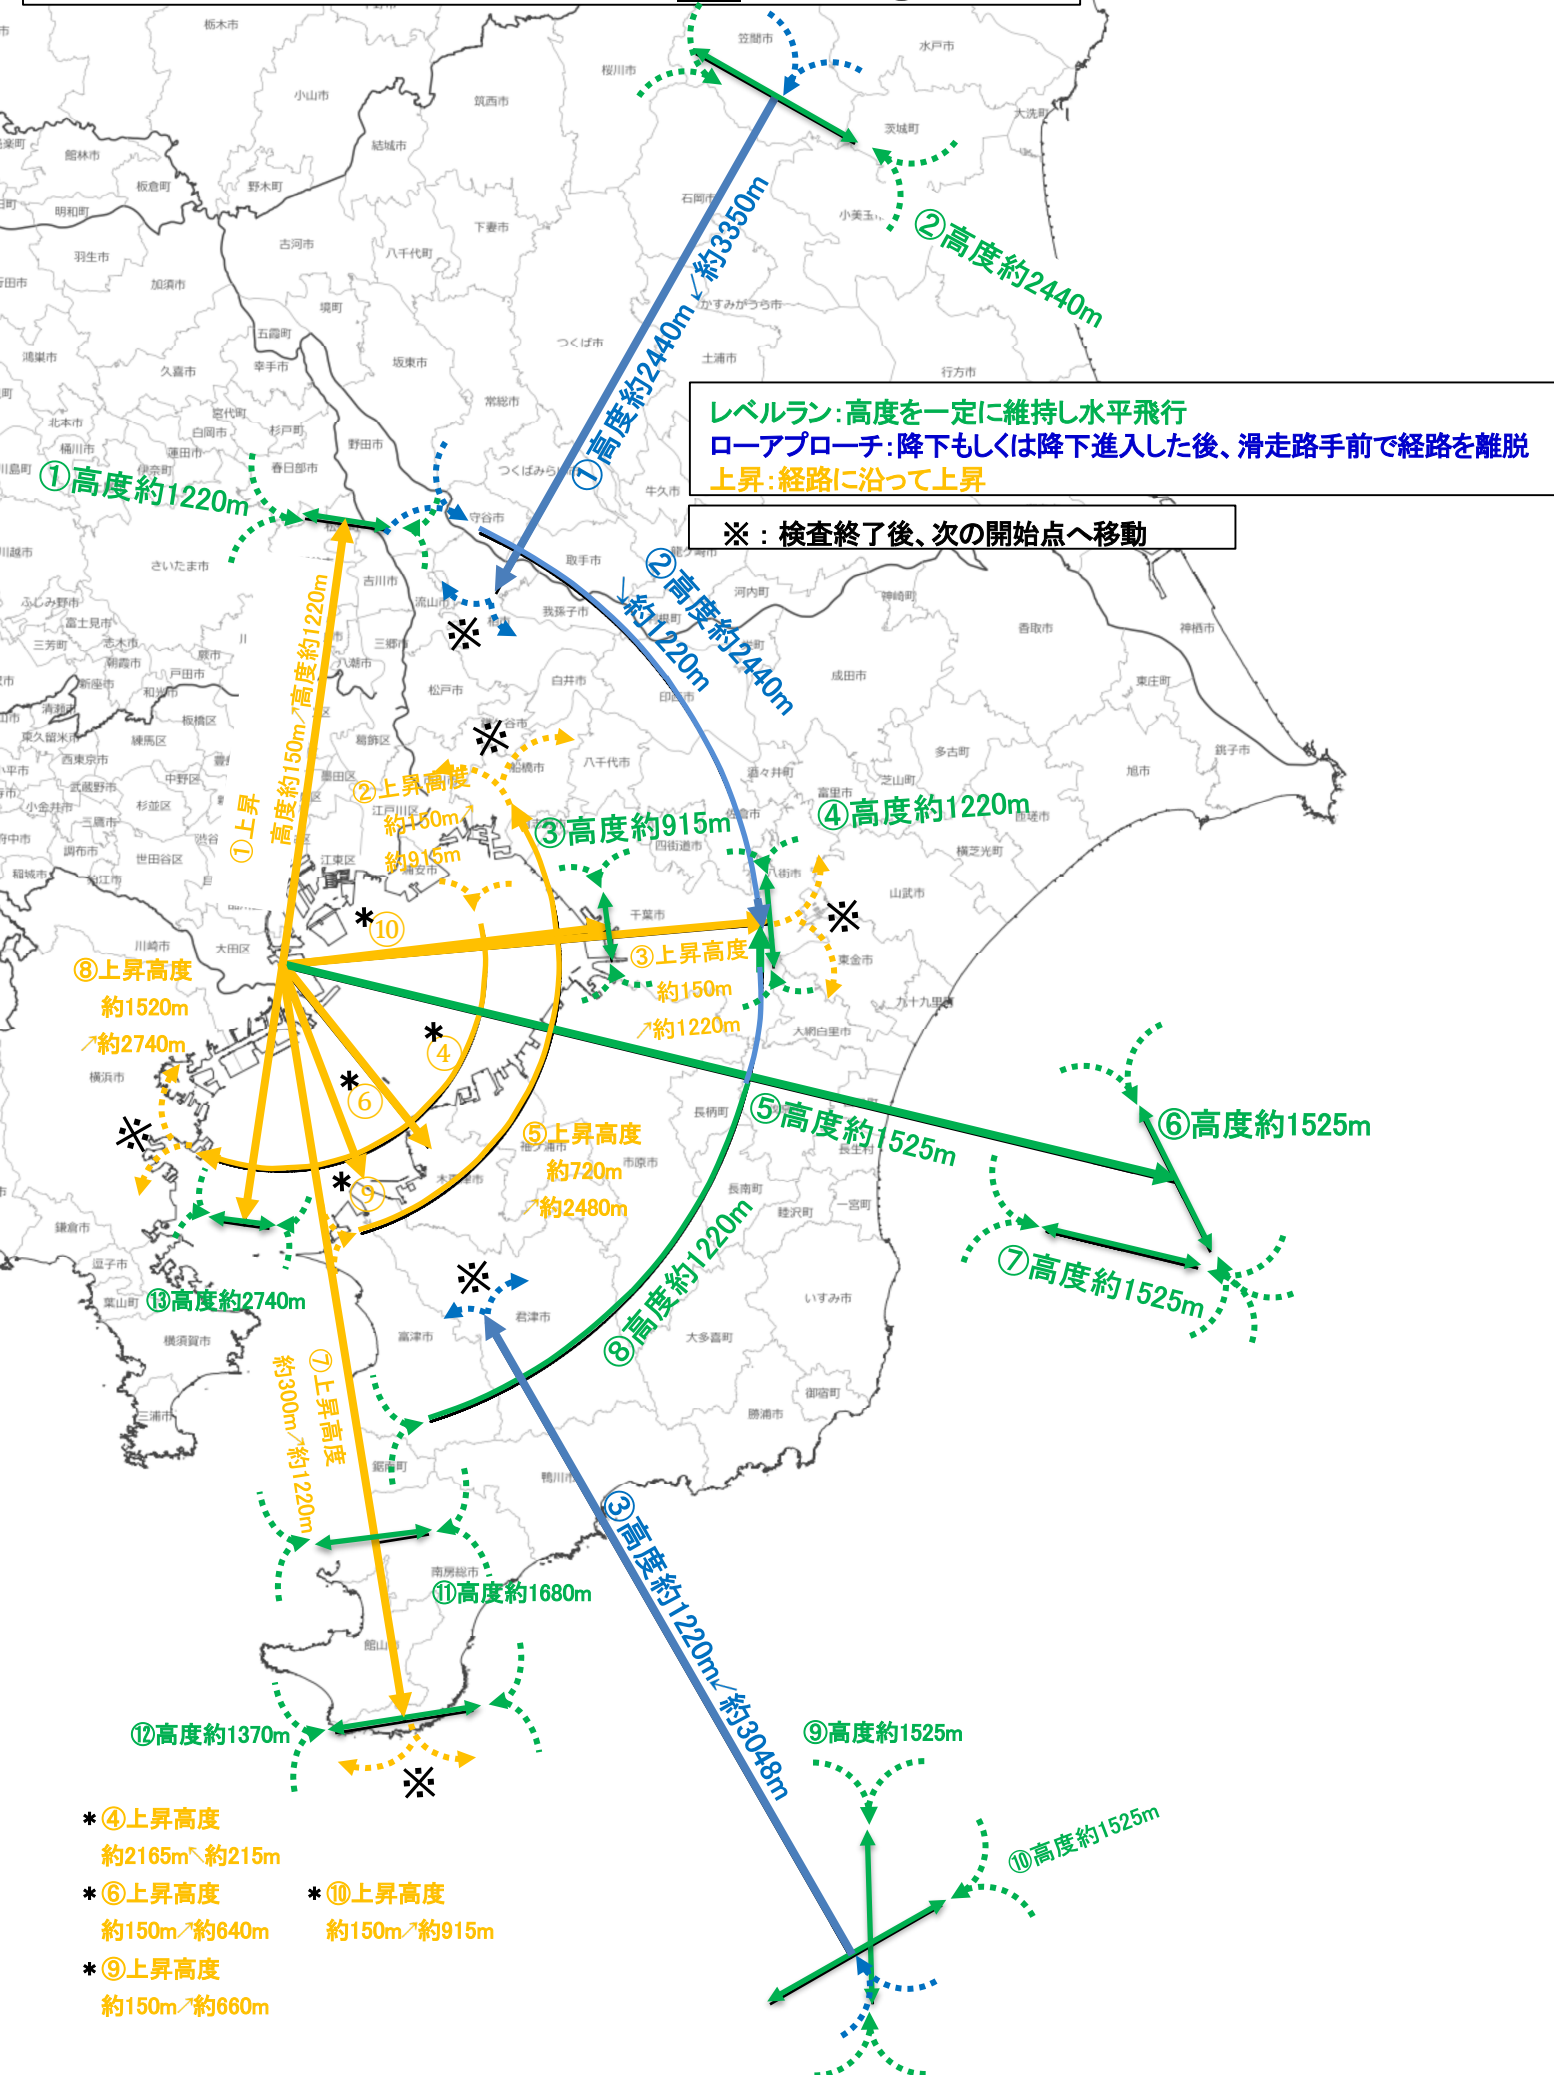


東京VORDME特別検査 資料③

レベルラン: 高度を一定に維持し水平飛行


ローアプローチ: 降下もしくは降下進入した後、滑走路手前で経路を離脱

上昇: 経路に沿って上昇

※: 検査終了後、次の開始点へ移動

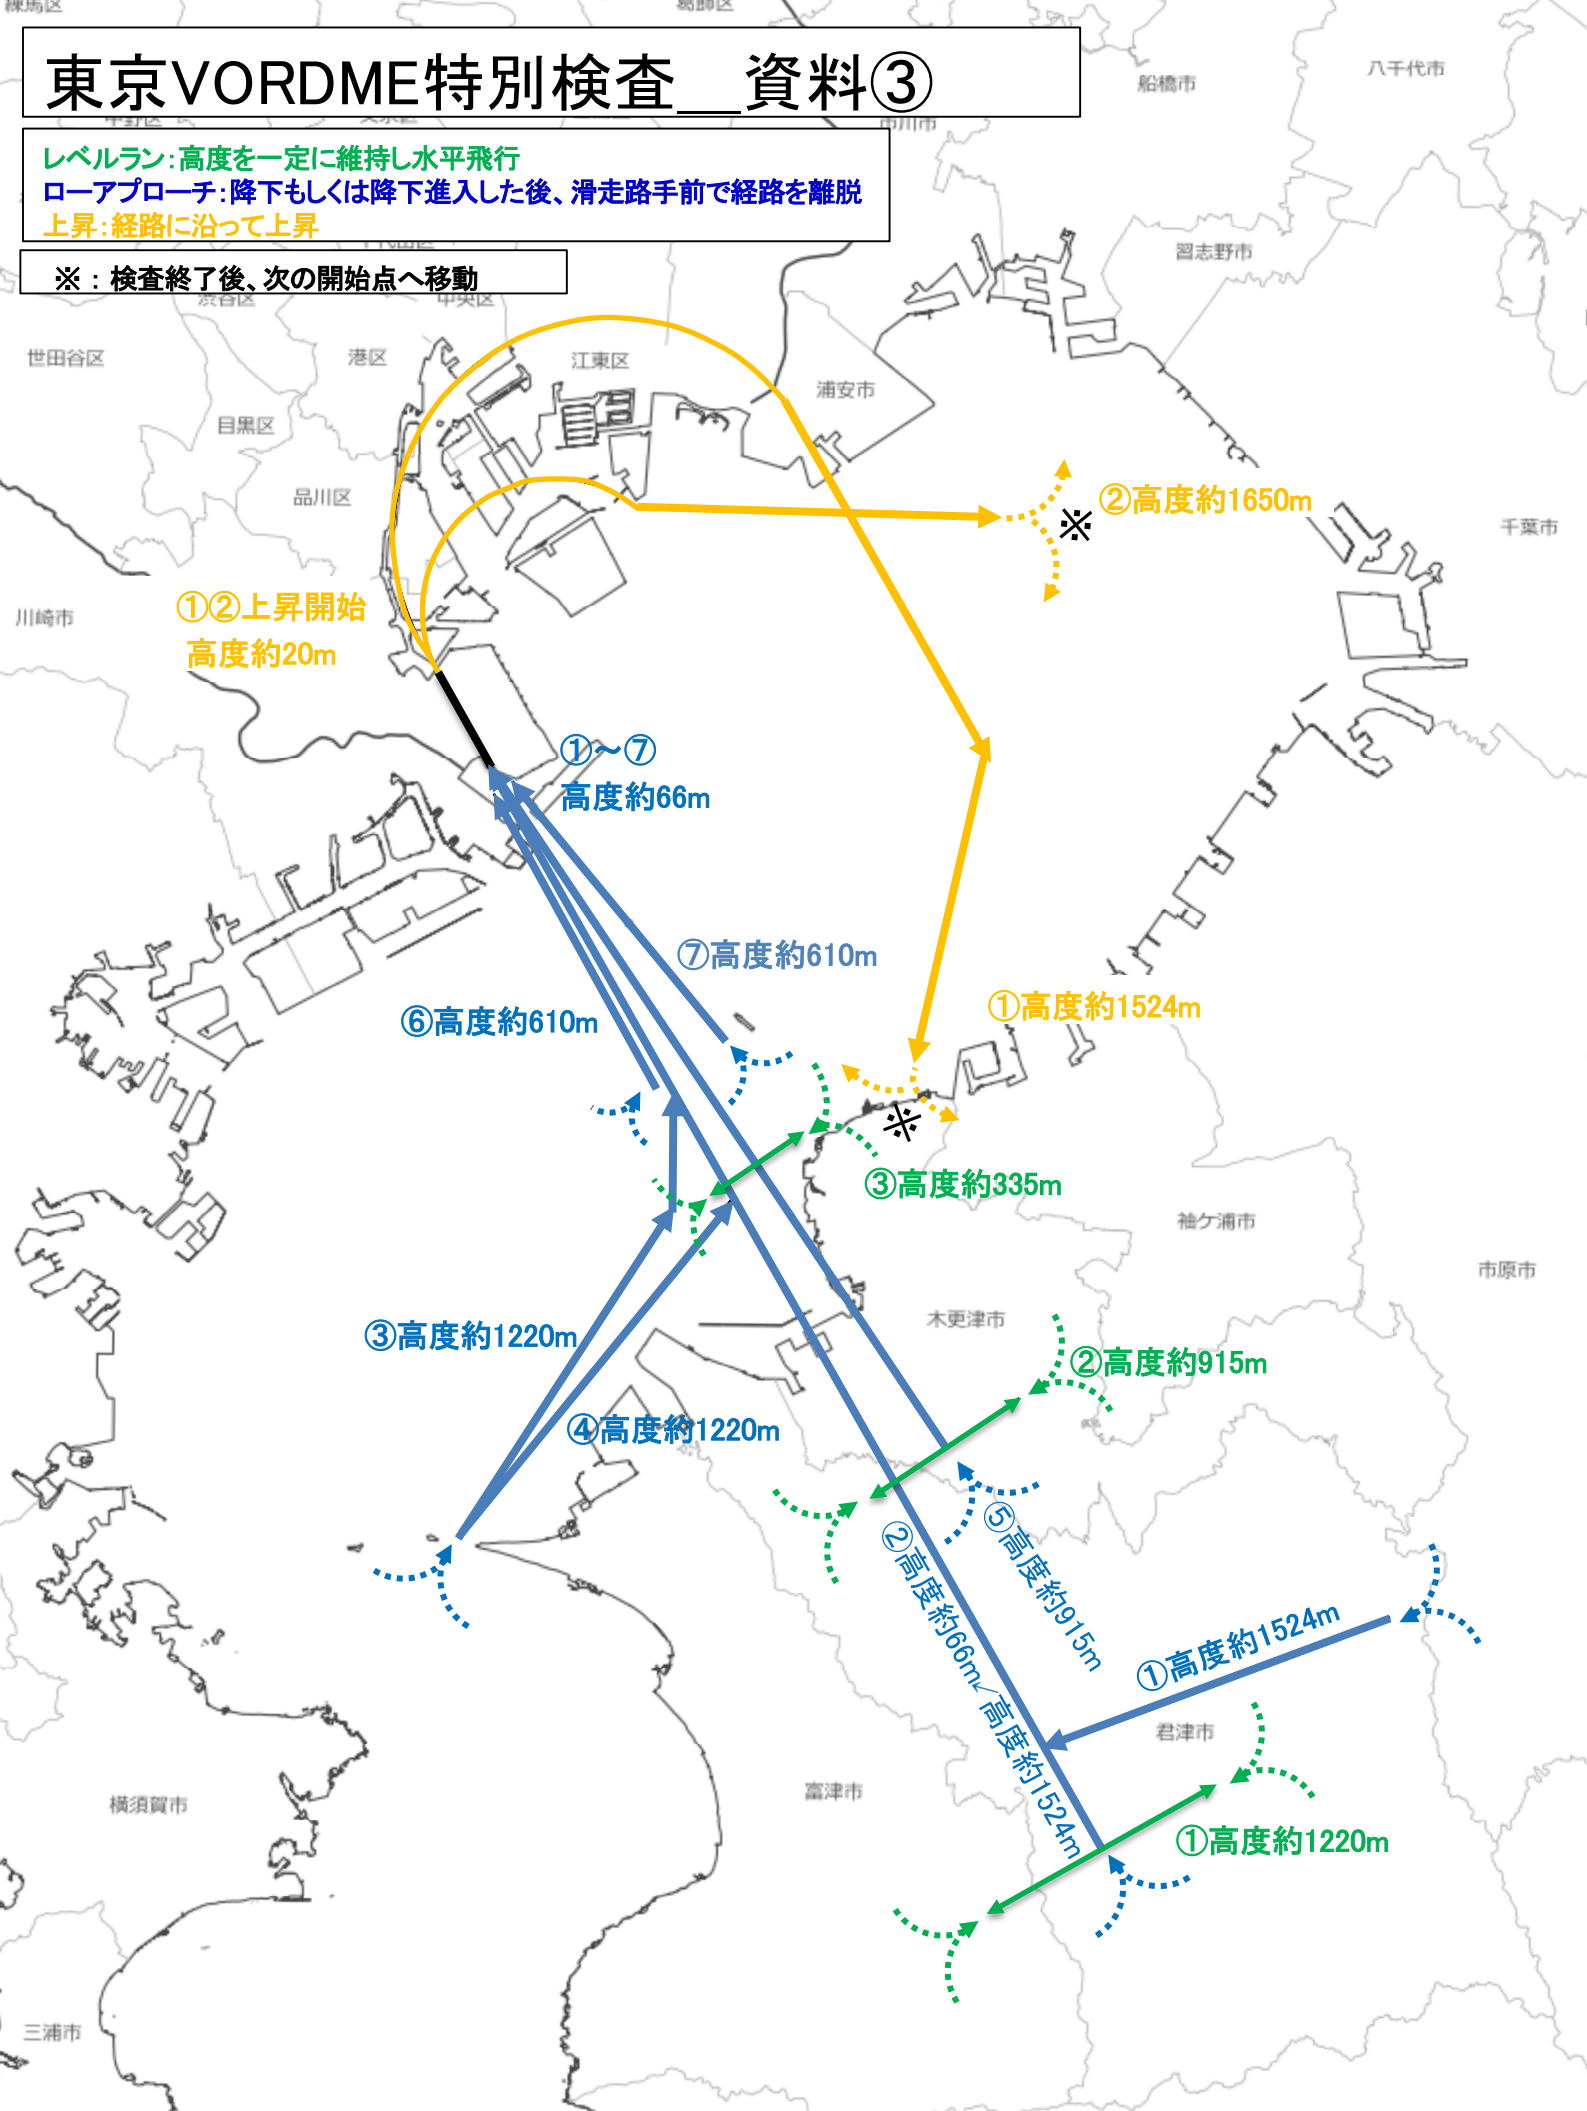

東京VORDME特別検査__資料④

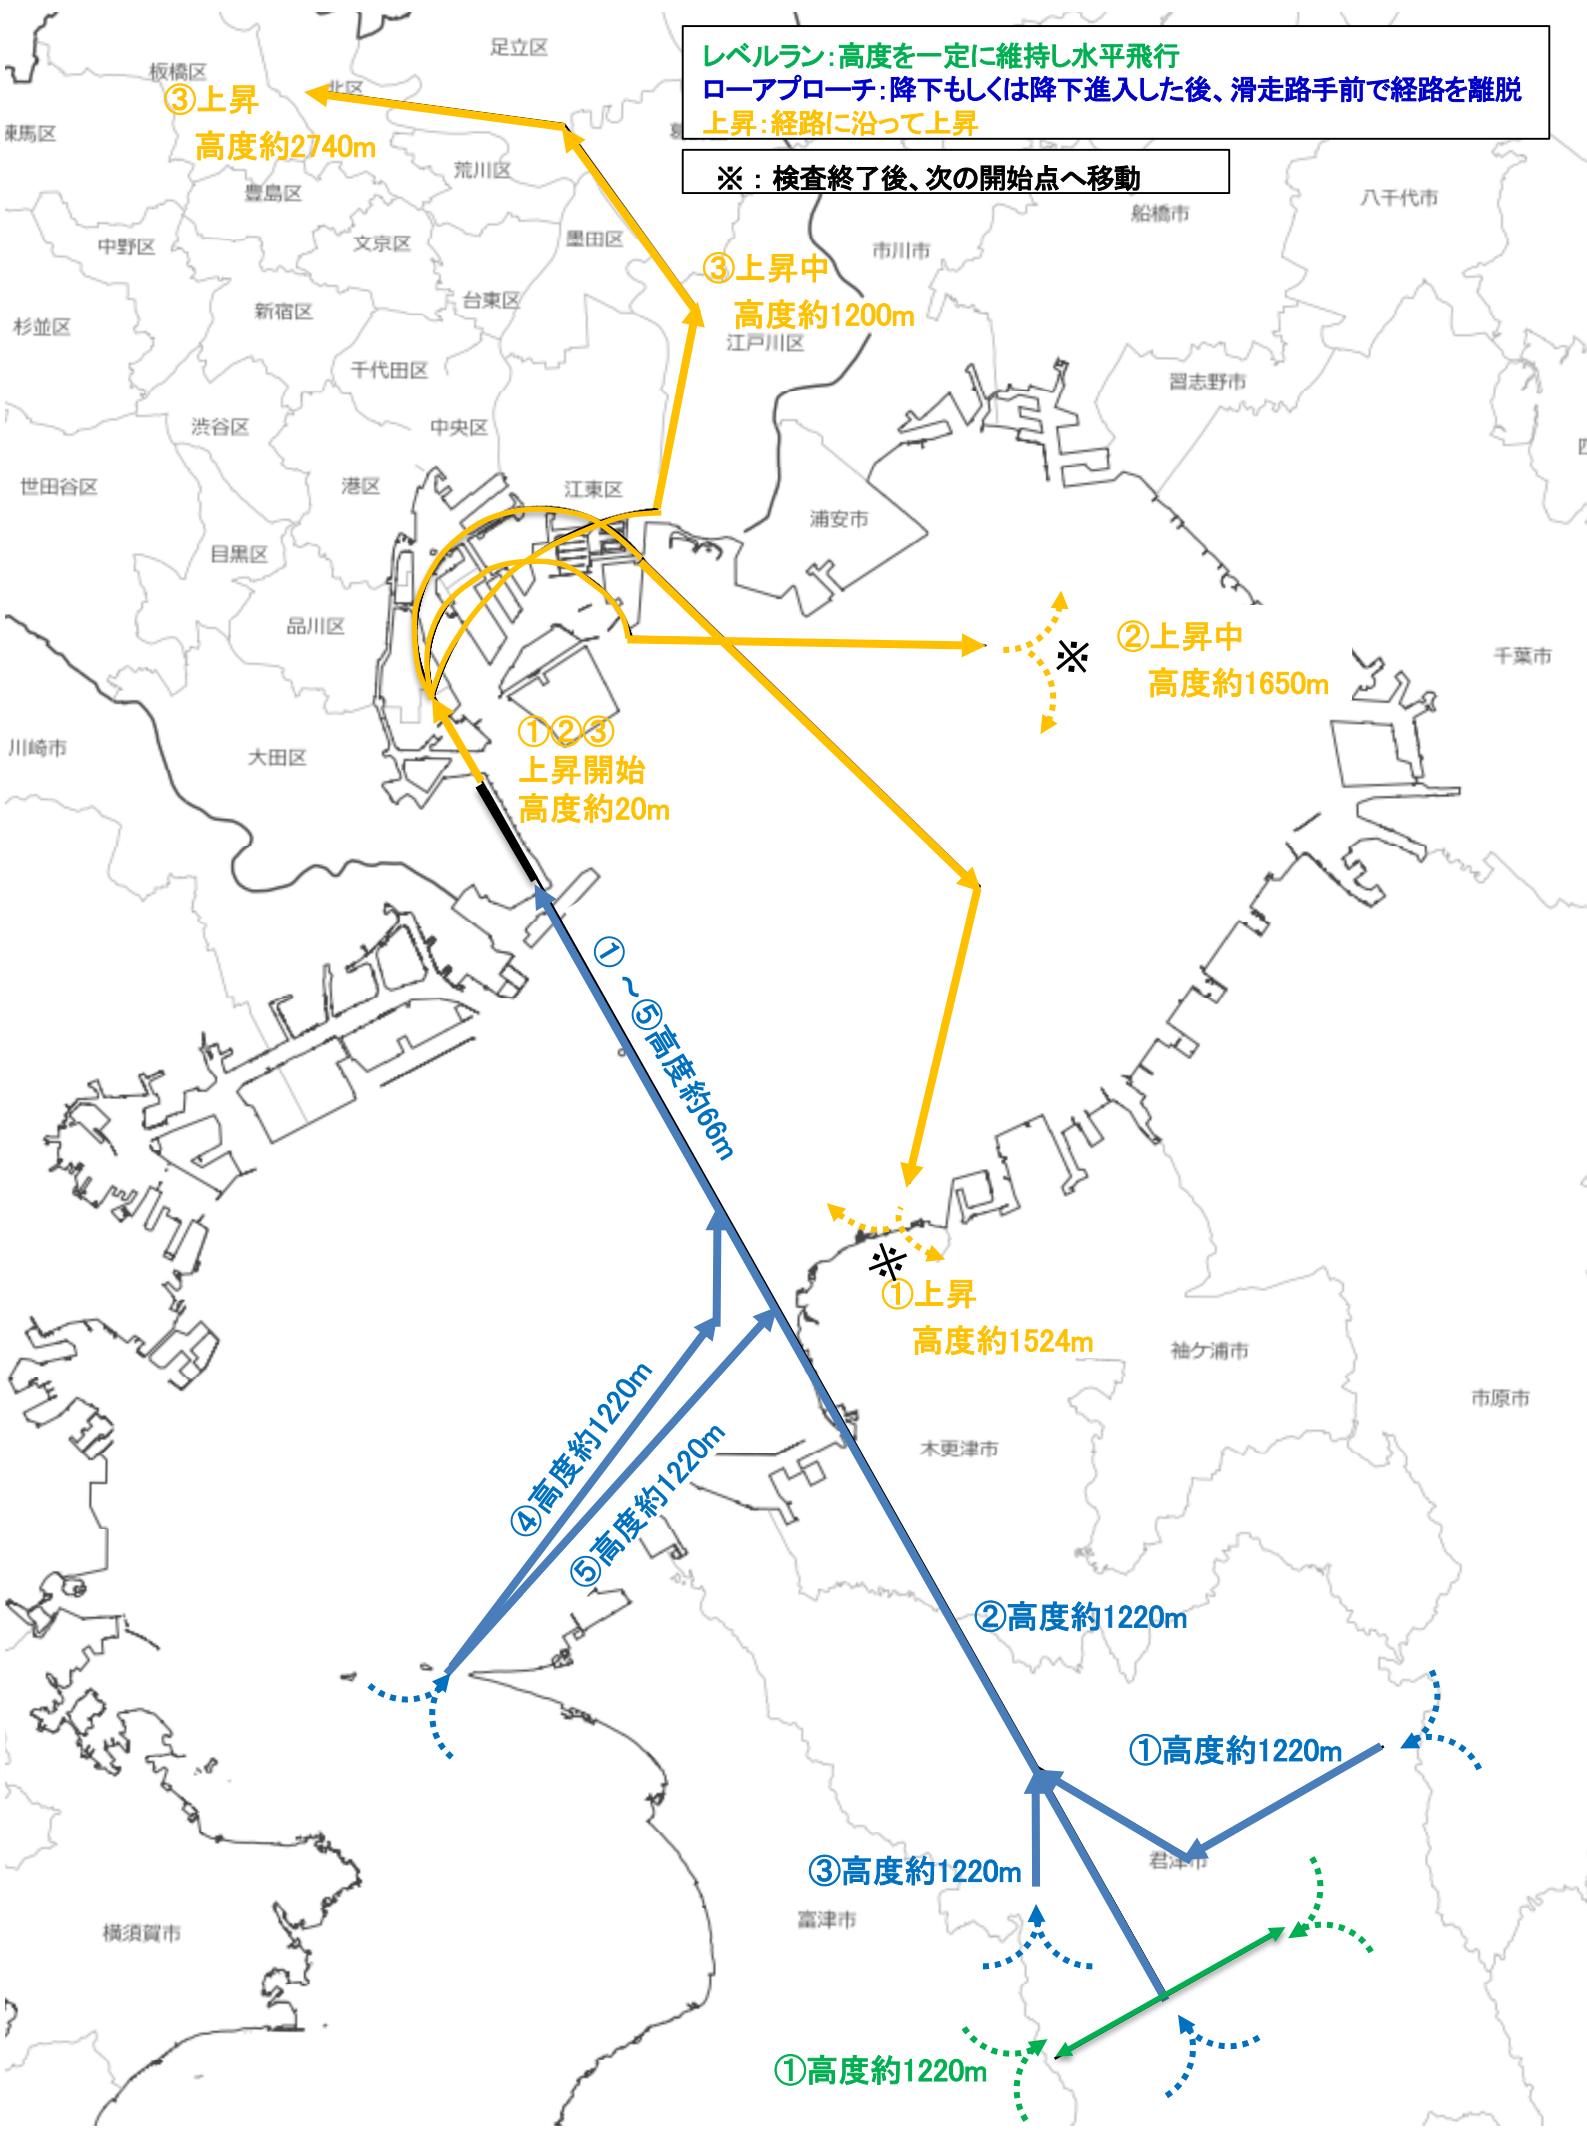

東京VORDME特別検査 資料⑤


レベルラン: 高度を一定に維持し水平飛行

ローアプローチ: 降下もしくは降下進入した後、滑走路手前で経路を離脱

上昇: 経路に沿って上昇

※: 検査終了後、次の開始点へ移動


①②高度約910m

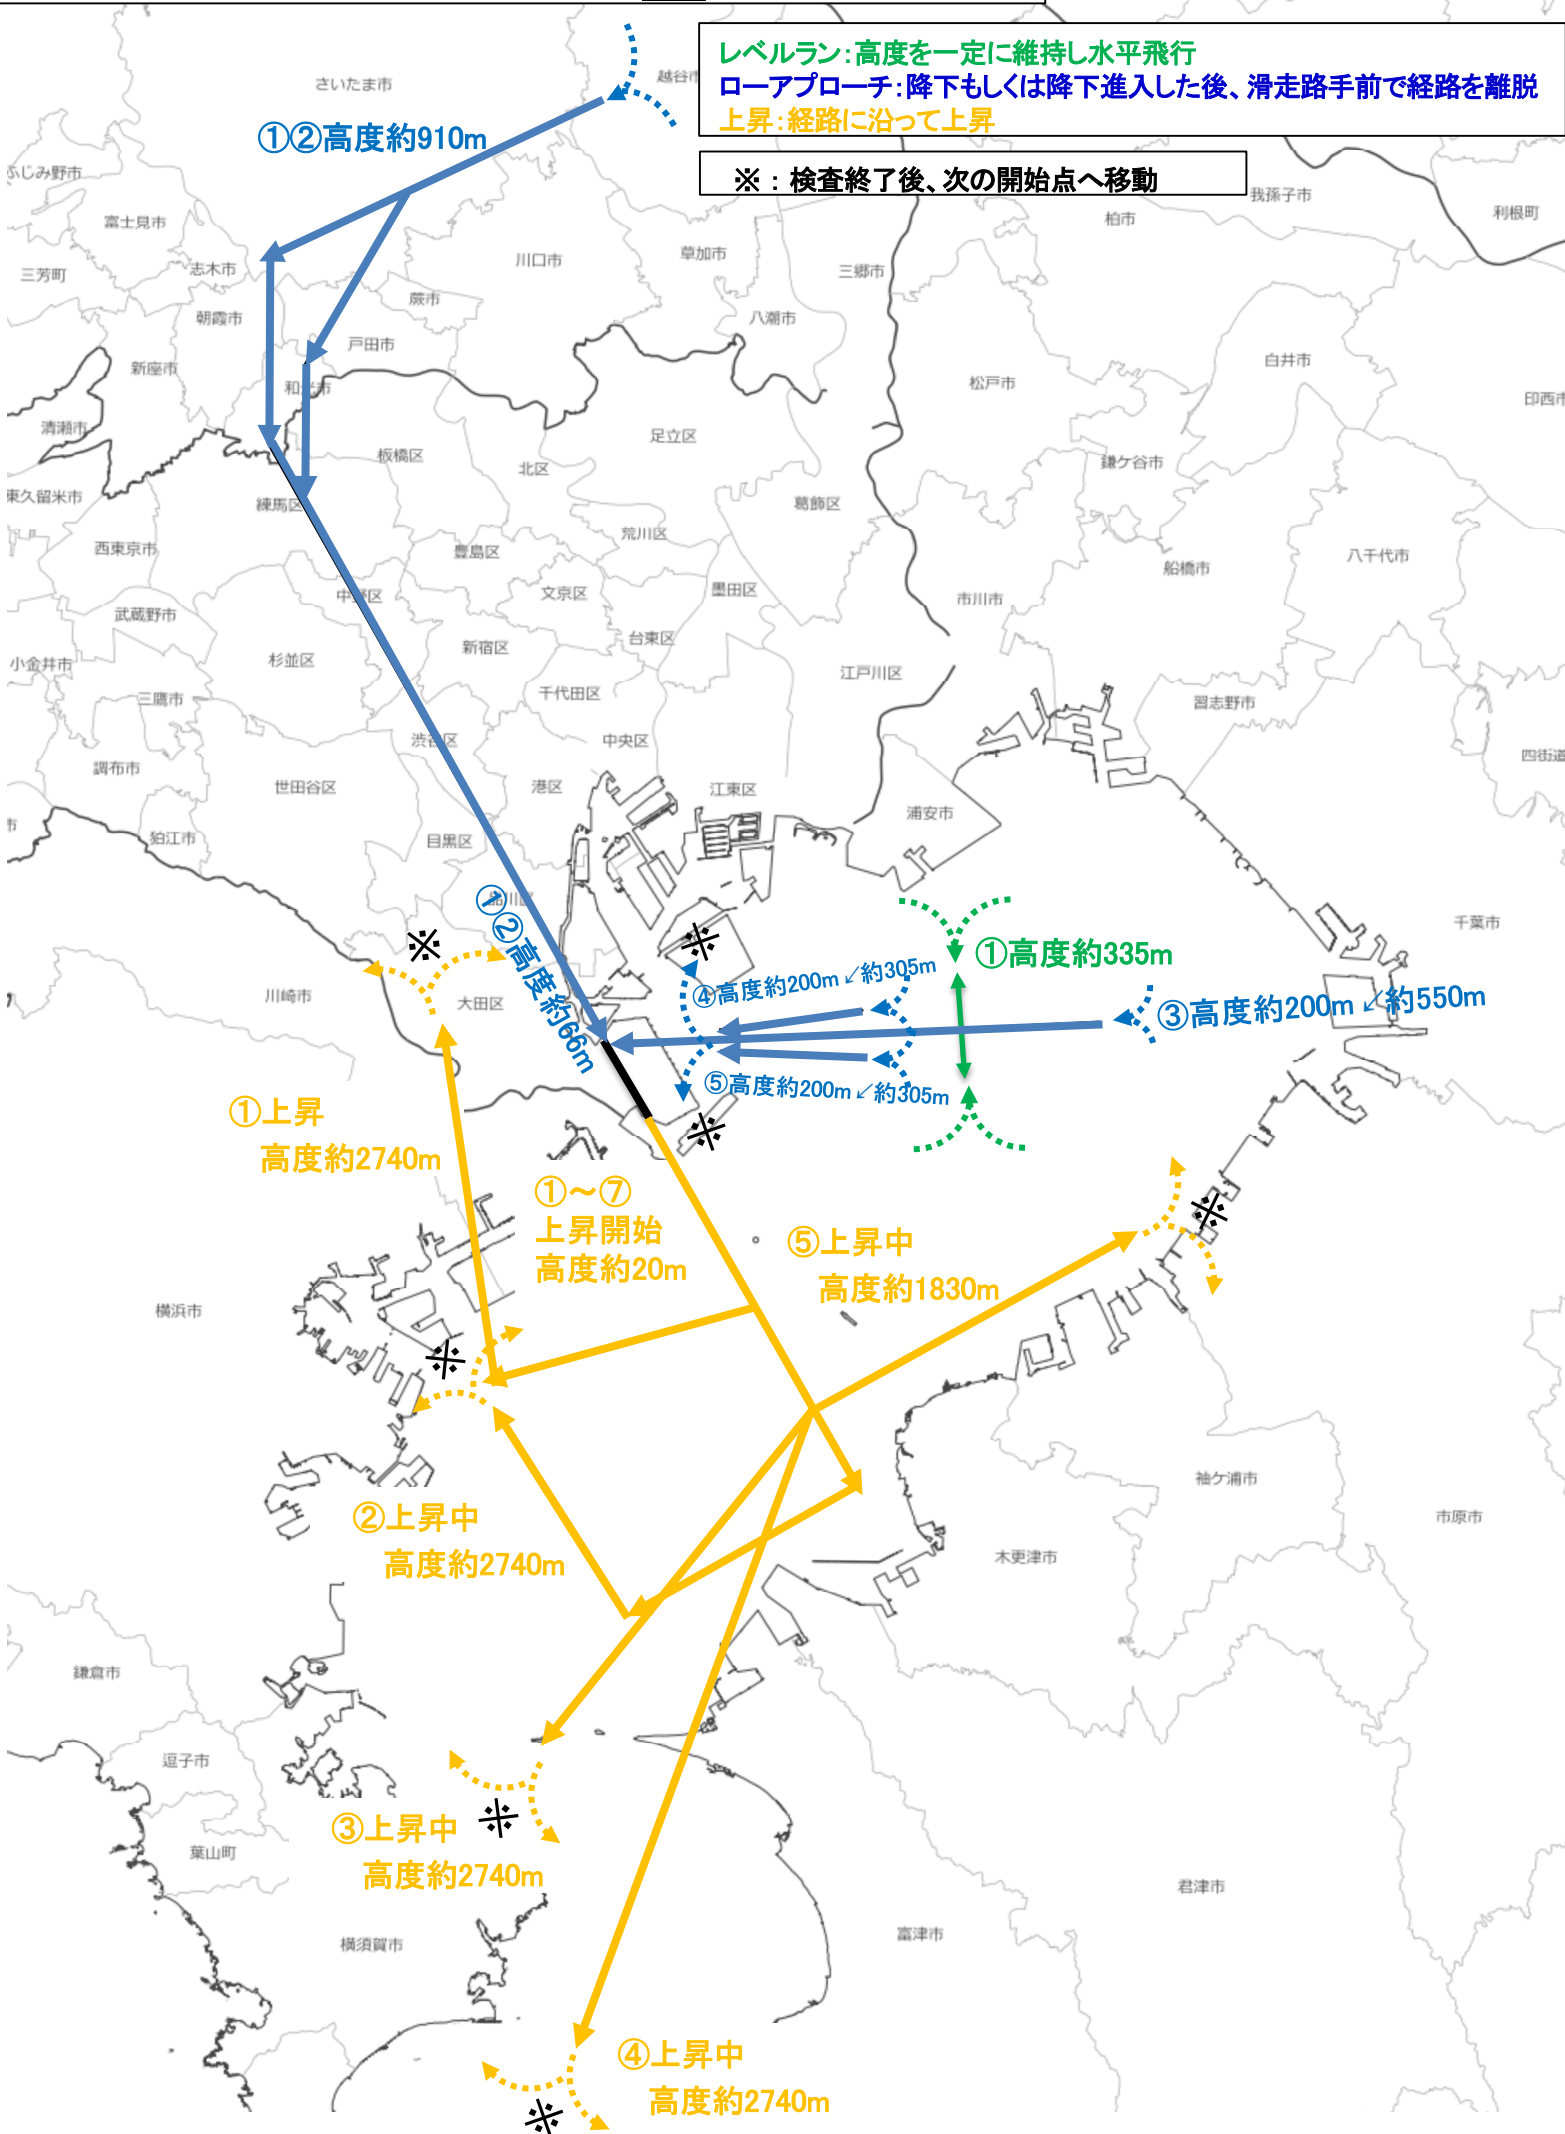


東京VORDME特別検査__資料⑥

ローアプローチ: 降下もしくは降下進入した後、滑走路手前で経路を離脱
上昇: 経路に沿って上昇

※: 検査終了後、次の開始点へ移動

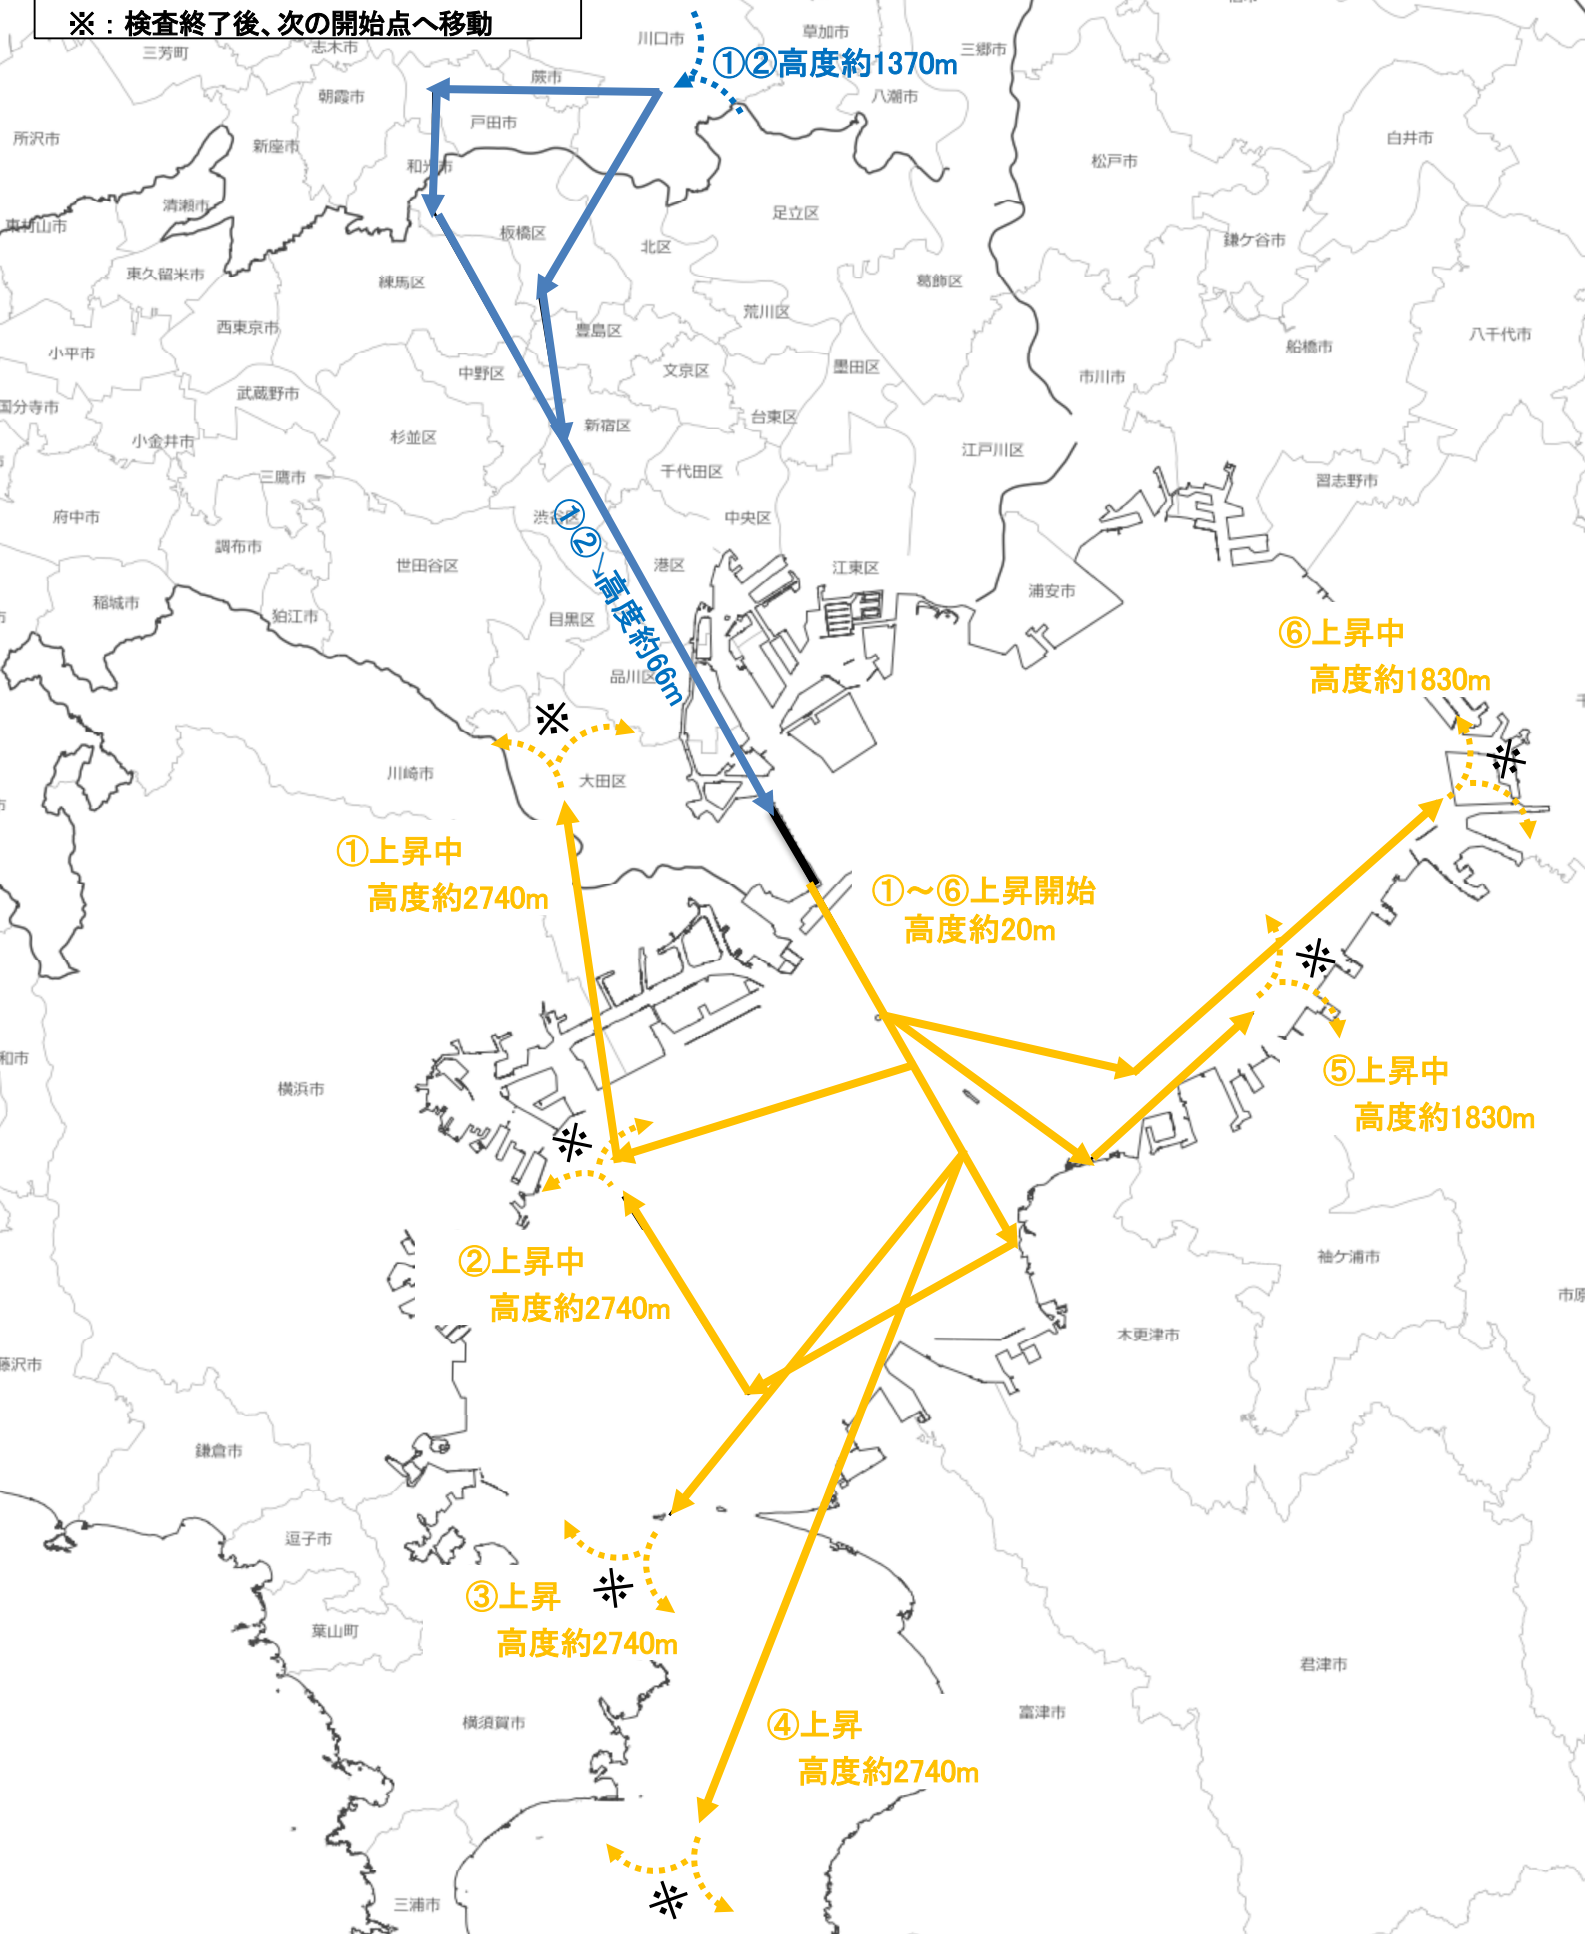


東京VORDME特別検査 資料⑦

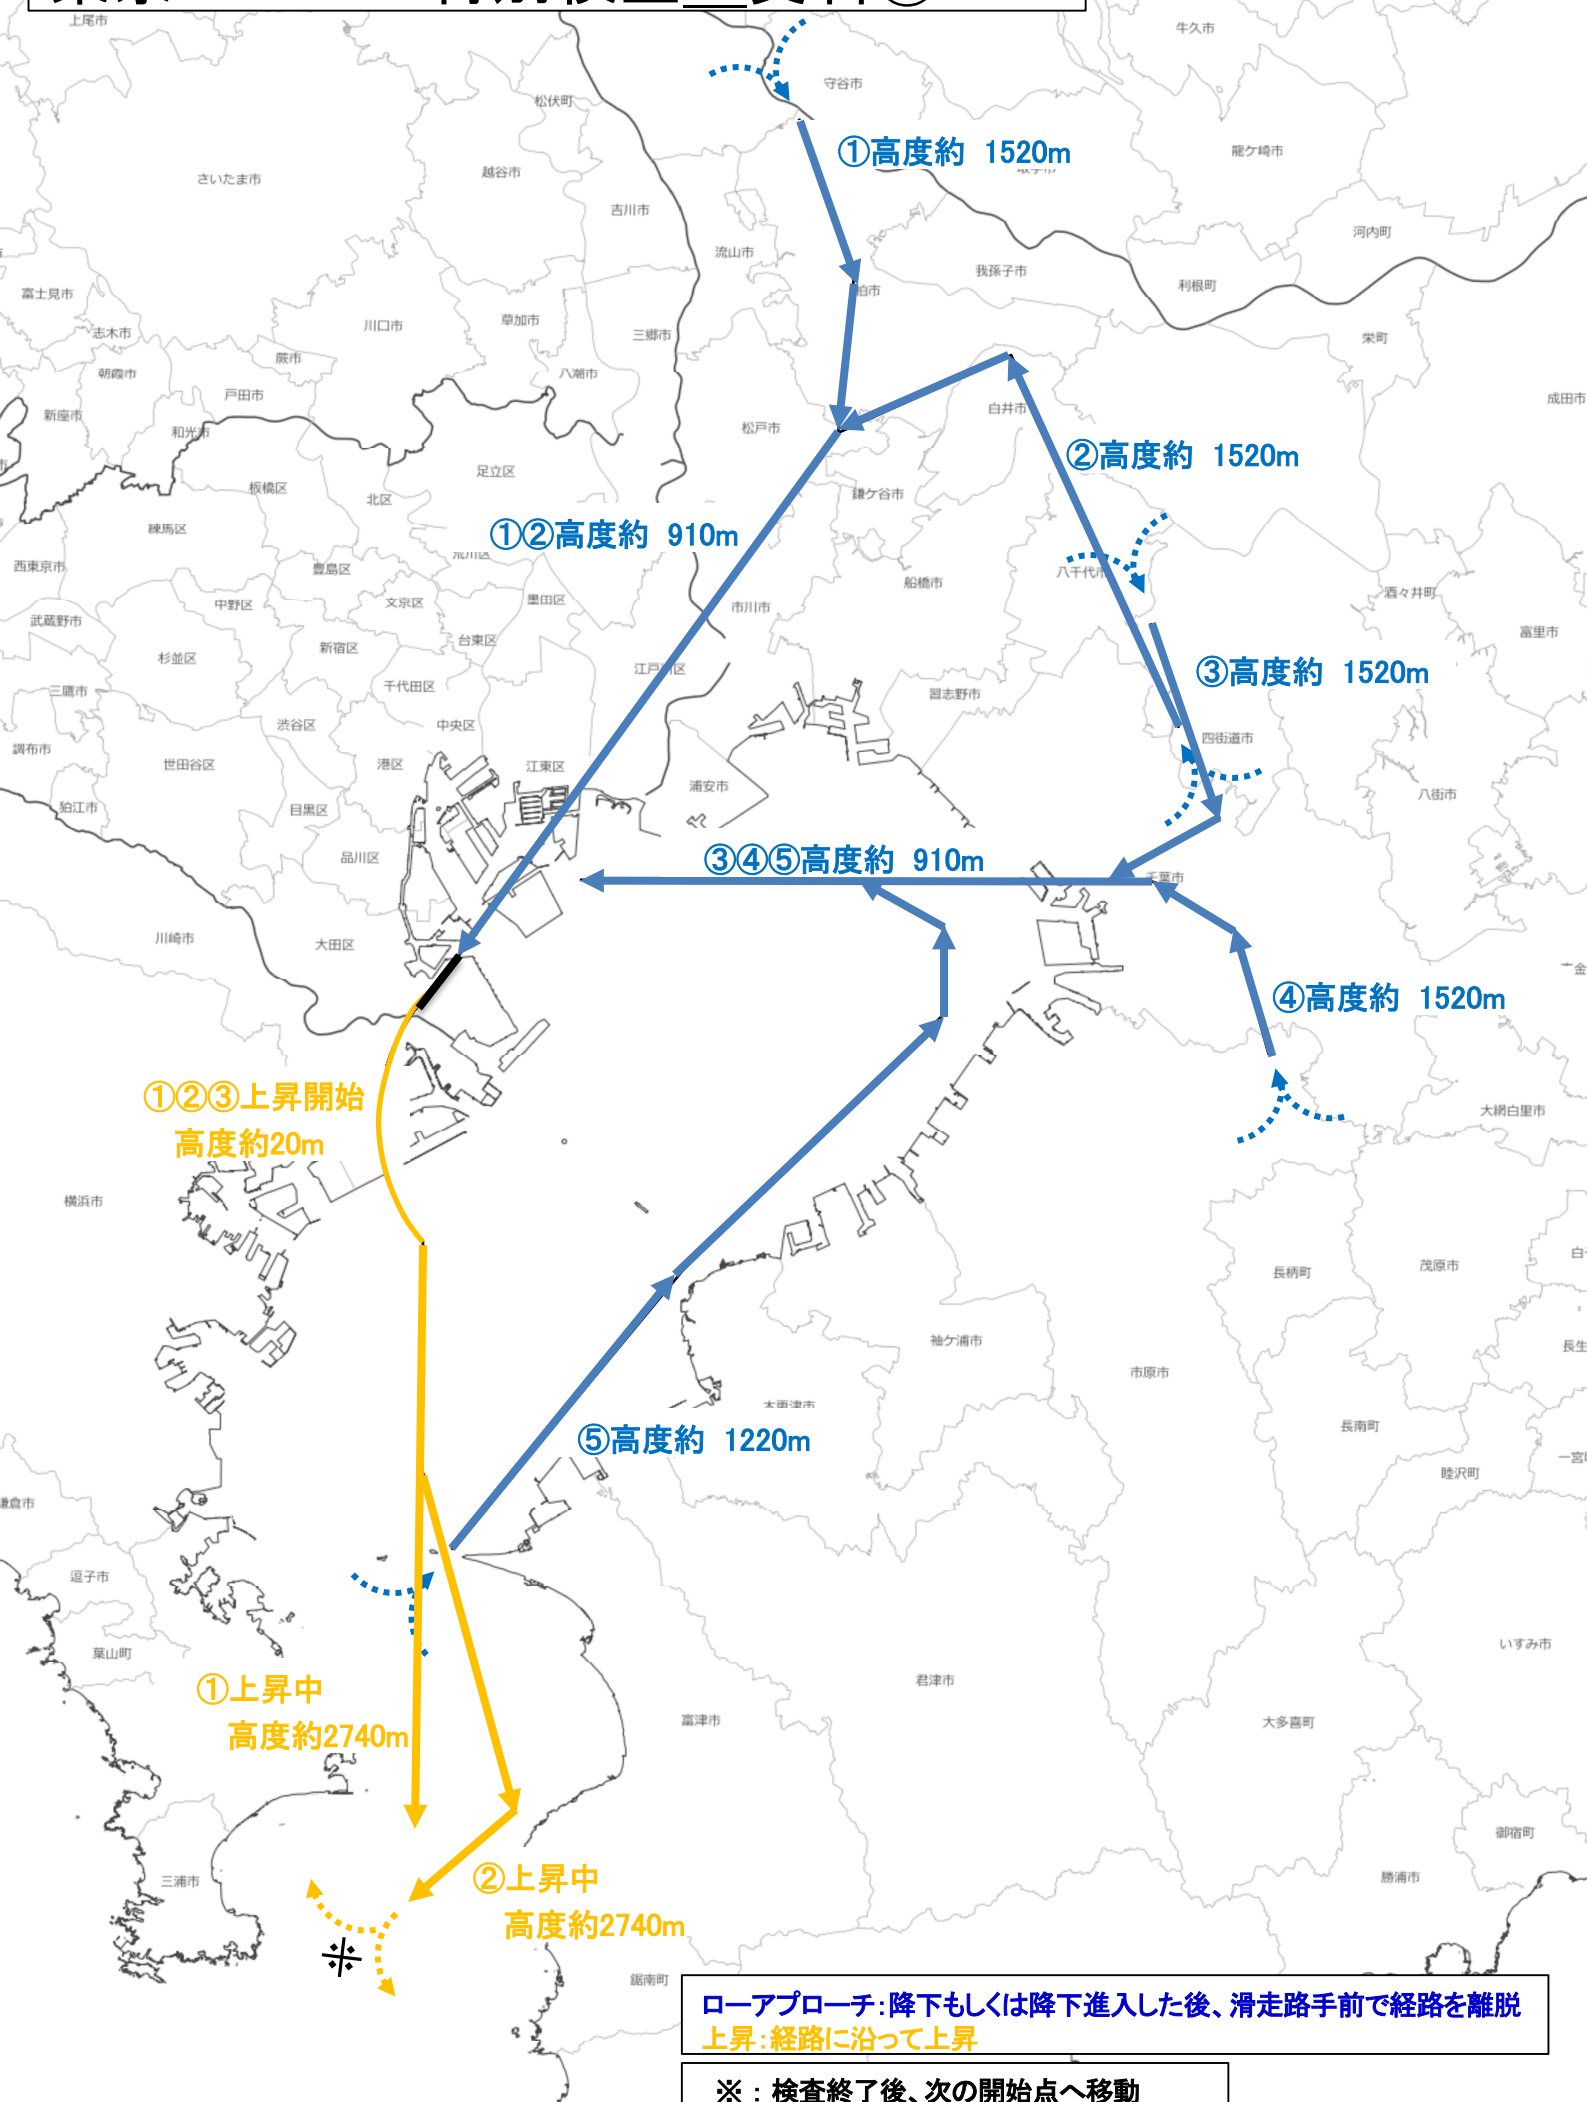

東京VORDME特別検査資料⑧

上昇:経路に沿って上昇

※: 検査終了後、次の開始点へ移動

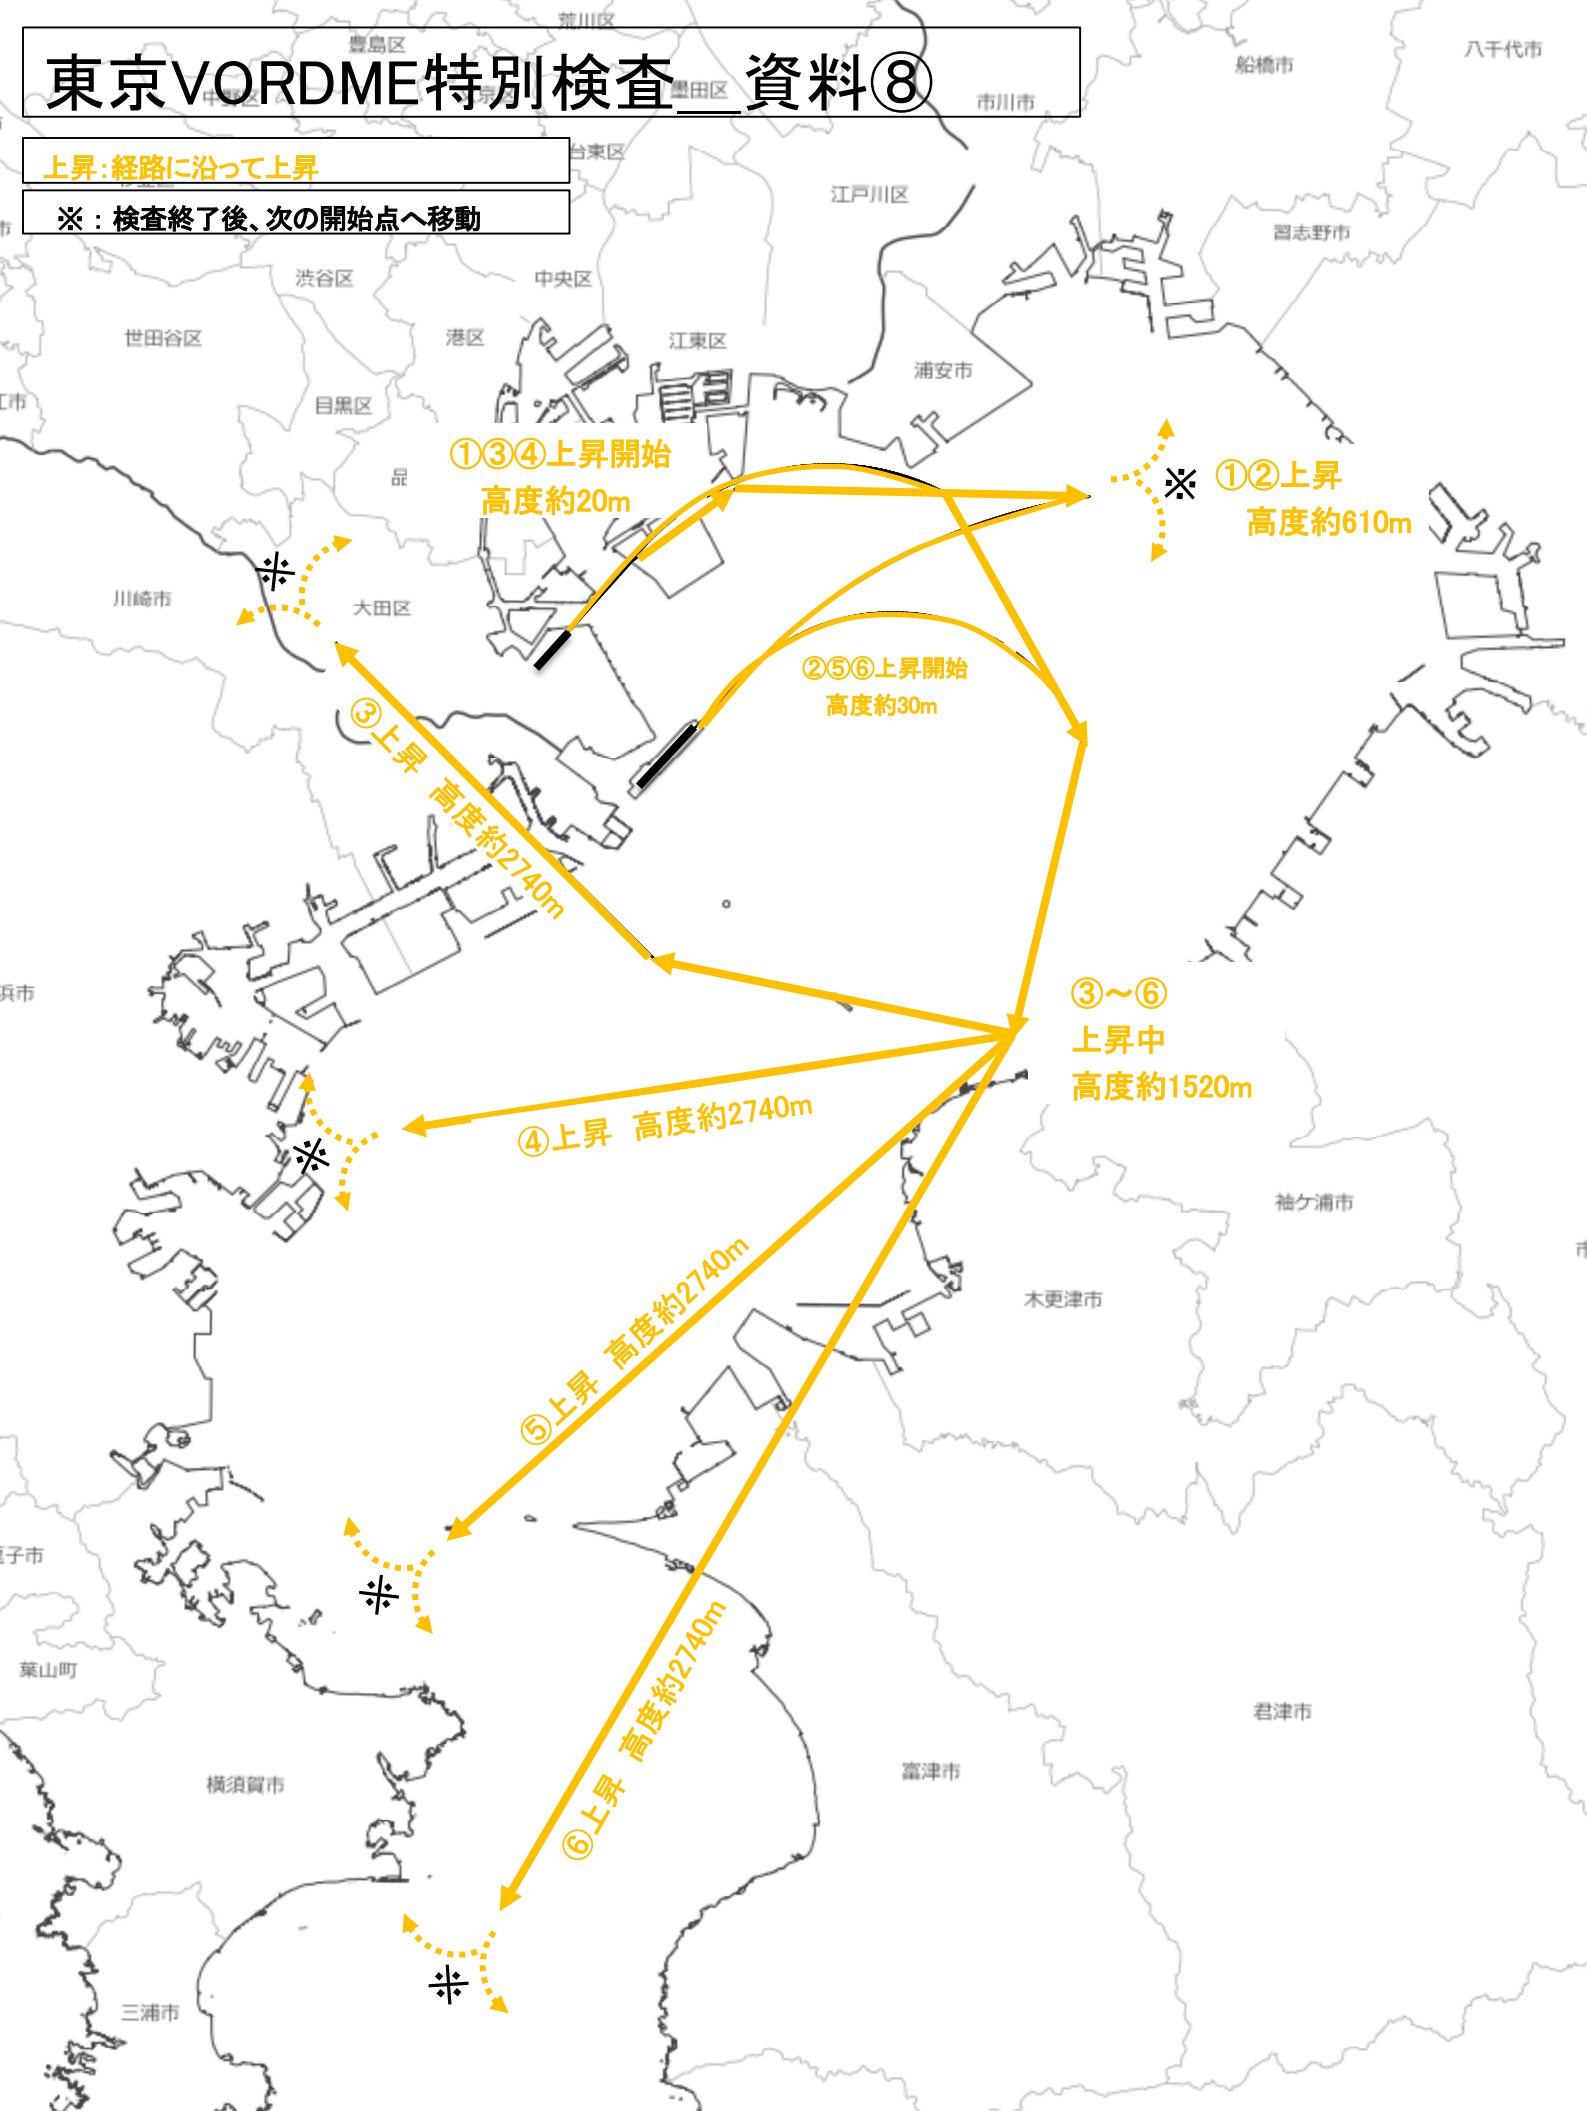

東京VORDME特別検査 資料⑨

ローアプローチ: 降下もしくは降下進入した後、滑走路手前で経路を離脱

レベルラン: 高度を一定に維持し水平飛行

※: 検査終了後、次の開始点へ移動

